




Waschen Sie die Hände mit einer milden Seife und Wasser.



Um die Verpackung zu öffnen, stecken Sie einen Finger etwa bis zur Hälfte durch die vorgestanzte Fingeröffnung. Ziehen Sie die Verpackung mit leichtem Zug entlang des markierten Pfeils nach unten auf.

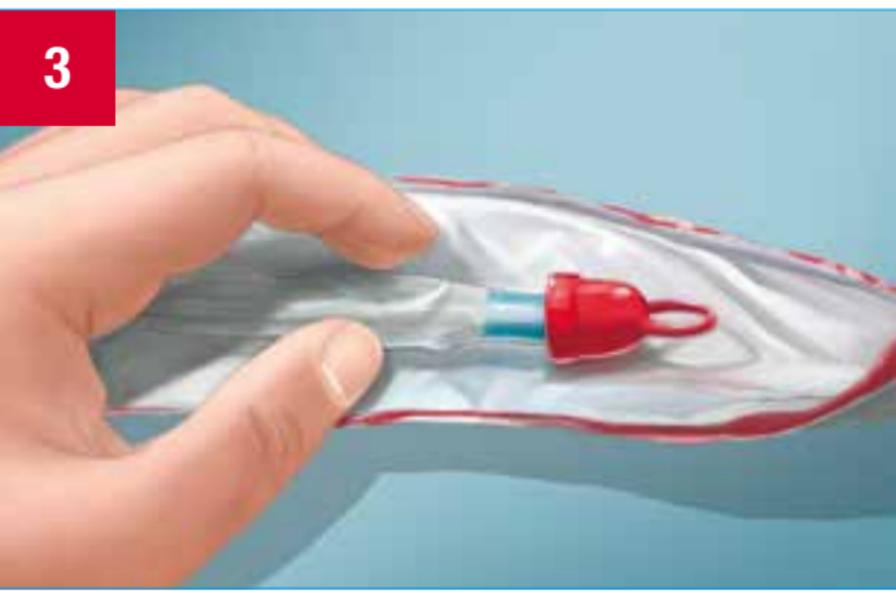

Lassen Sie den Katheter in der geöffneten Verpackung liegen, während Sie sich auf das Katheterisieren vorbereiten.



Nehmen Sie den Penis in die Hand. Schieben Sie die Vorhaut zurück und reinigen Sie die Eichel und den Harnröhreneingang mit einer milden, nicht parfümierten Seife oder nicht alkoholischen feuchten Reinigungstüchern. Desinfizieren Sie den Bereich anschließend mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel.



Greifen Sie den Katheter gleichzeitig an beiden Enden und lösen Sie unter leichtem Zug dadurch die aufgerollte Form des Katheters.

Zum Auffalten des Beutels schieben Sie das Papierband beiseite.

Entfernen Sie nun die rote Sterilschutzkappe von der Schutzhülse des Katheters.



Halten Sie den Katheter in einer Hand und schieben Sie (gegebenenfalls mit der anderen Hand) den Katheter nach vorne, bis dessen Spitze in der Schutzhülse steckt.

Dadurch wird diese während des Einführens stabilisiert. Achten Sie darauf, dass der Katheter noch nicht aus der Schutzhülse heraus sichtbar ist.

*(bitte wenden)*





# VaPro Plus Pocket™

berührungsfreie hydrophile intermittierende Einmalkatheter



**Deutschland**

**Hollister Incorporated**

Niederlassung Deutschland

Riesstraße 25

D-80992 München

**Beratung:**

Telefon: 0 800 / 1 01 50 23

(gebührenfrei)

[beratungsteam@hollister.com](mailto:beratungsteam@hollister.com)

[www.hollister.de](http://www.hollister.de)

[www.hollister-lifeblog.de](http://www.hollister-lifeblog.de)